

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, תשע"ד-2014

בריאות – שירותים רפואיים – מכשירי החייאה במקומות ציבוריים

תוכן ענינים

2	Go	הגדרות	1	סעיף
2	Go	דרישות ממכשיר החייאה	2	סעיף
2	Go	חובת הצבת מכשיר החייאה	3	סעיף
2	Go	עמדת מכשיר החייאה	4	סעיף
2	Go	שלט המכוון אל מכשיר החייאה	5	סעיף
2	Go	הוראות נוספות לעניין השילוט	6	סעיף
2	Go	הוראות הפעלה	7	סעיף
3	Go	בדיקות תקינות תקופתיות	8	סעיף
3	Go	תצהיר	9	סעיף
3	Go	הוראת מעבר	10	סעיף
3	Go	תוספת ראשונה		
3	Go	תוספת שנייה		
4	Go	תוספת שלישית		
5	Go	תוספת רביעית		

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, תשע"ד-2014*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2 ו-6 לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ולעניין תקנה 2 בהסכמת שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –
 - "חוק ציוד רפואי" – חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012;
 - "המנהל" ו"הפנקס" – כהגדרתם בחוק ציוד רפואי;
 - "תעודת הרישום" – כמשמעותה בחוק ציוד רפואי.
2. מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל בפנקס כמכשיר החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום והוא יהיה נייד וקל לנשיאה.
3. (א) מחזיק מקום ציבורי יציב מכשיר החייאה אחד לפחות במיקום מרכזי ונגיש במקום הציבורי שבהחזקתו.
- (ב) מחזיק מקום ציבורי יציב במקום הציבורי שבהחזקתו יותר ממכשיר החייאה אחד במיקום מרכזי ונגיש, בהתקיים אחד מאלה:
 - (1) בבניין שבו יותר מקומה אחת יוצב מכשיר החייאה אחד לפחות בכל שתי קומות צמודות, שמספר המבקרים בשתייהן יחד כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום;
 - (2) בקומה שאורכה עולה על 300 מטרים, ומספר המבקרים באותה קומה כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום, יוצבו כמה מכשירי החייאה כך שהמרחק בין מכשיר החייאה אחד למכשיר החייאה הסמוך לו לא יעלה על 300 מטרים.
 - (ג) במקום ציבורי שבו קיימת עמדת עזרה ראשונה, יוצב מכשיר החייאה אחד מתוך מכשירי החייאה שקיימת חובה להציבם על פי תקנות משנה (א) או (ב), בסמוך לעמדת העזרה הראשונה ובלבד שהיא מצויה במקום מרכזי ונגיש.
4. (א) מחזיק מקום ציבורי יציב את מכשיר החייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה (להלן – עמדת מכשיר החייאה), שניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את מכשיר החייאה בקלות; עמדת מכשיר החייאה תוצב בגובה שלא יעלה על 150 סנטימטרים ולא יפחת מ-120 סנטימטרים מגובה הרצפה.
- (ב) מחזיק מקום ציבורי יציב שלט על עמדת מכשיר החייאה או לצדה בהתאם לתרשים שבתוספת הראשונה.
5. מחזיק מקום ציבורי יציב שלט המכוון אל מכשיר החייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השנייה בסימונים ובשינויים המחויבים; שלט כאמור יוצב במקום בולט לעין על פי האמור להלן:
 - (1) במקום ציבורי במבנה – בכל קומה, בין אם הוצבה בה עמדת מכשיר החייאה, ובין אם לאו באופן שהמרחק בין שלט לשלט בכל קומה לא יעלה על 150 מטרים;
 - (2) במקום ציבורי שאינו במבנה – בכניסה אליו.
6. מחזיק מקום ציבורי ידאג כי בשלט לפי תקנות 4(ב) ו-5 יתקיימו כל אלה:
 - (1) הוא עשוי חומר קשיח;
 - (2) הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה;
 - (3) אם השלט מוצב במקום חשוך – יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר.
7. מחזיק מקום ציבורי יתקין בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, הוראות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השלישית, הוראות הפעלה

* פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7397 מיום 17.7.2014 עמ' 1509.

שבראשן יצוין כי הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר.

8. (א) מחזיק מקום ציבורי ידאג לתקינות מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום.

(ב) מחזיק מקום ציבורי ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, תקינות הסוללות, את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר ההחייאה, אם ישנה, וכי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר.

(ג) מחזיק מקום ציבורי יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ופירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנות משנה (א) ו-(ב); העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון, שנערכו לפי תקנת משנה (ב), יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה; תוצאות הבדיקות שנערכו ב-12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק המקום הציבורי.


(ד) מחזיק מקום ציבורי יציג את תוצאות הבדיקות למפקח שמונה לפי החוק, על פי דרישתו.

9. מחזיק מקום ציבורי ישלח למשרד הכלכלה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בכל שנה, תצהיר חתום ומאומת על ביצוע בדיקות תקינות למכשיר ההחייאה כאמור בתקנות אלה, על פי הנוסח המפורט בתוספת הרביעית.

10. עד לתחילתו של חוק ציוד רפואי יראו לעניין תקנות אלה מכשיר החייאה הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (להלן – פנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים) כרשום בפנקס כאמור בתקנה 2, ואת תנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים כהוראות שנקבעו בתעודת הרישום כמשמען בתקנה 8(א); רישומו של מכשיר כאמור יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של הרישום כאמור, אלא אם כן נמחק קודם לכן לפי הוראות חוק ציוד רפואי.


תוספת ראשונה

(תקנה 4(ב))

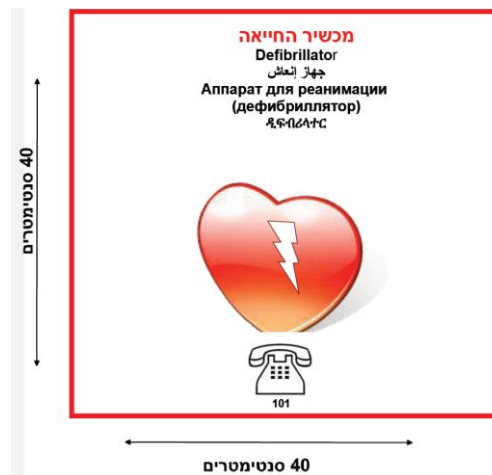

תוספת שנייה

(תקנה 5)

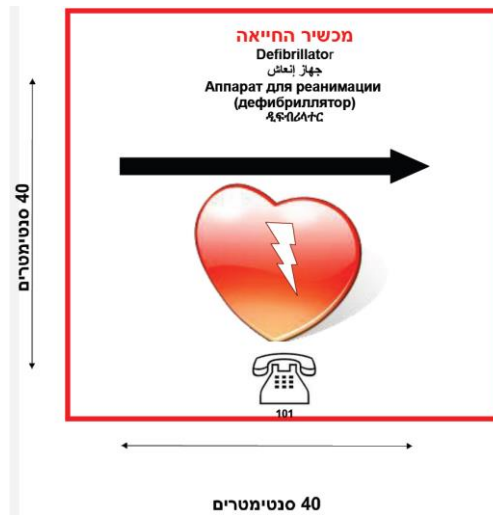

תוספת שלישית

(תקנה 7)

השלט יהיה ברוחב של 100 סנטימטרים ובאורך של 120 סנטימטרים

עברית	ערבית	אנגלית	רוסית	אמהרית
הוראות פעולה לטיפול באדם הלוקה בלב	تعليمات التعامل مع شخص يعاني من جلطة في القلب	Instructions for action for an individual undergoing a heart attack	Инструкции по оказанию помощи при сердечном приступе	የልብ ድካም ችግር ለተፈጠረበት ግለሰብ ስለሚወሰድ እርምጃ መስጫ
הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר	يتم تشغيل الجهاز بيد شخص صاحب المعرفة بتشغيل الجهاز.	Operation of the equipment is by those who have the knowledge	Пользоваться аппаратом для реанимации может человек имеющий знания по его применению	መሳሪያውን መጠቀም የሚችሉት አጠቃቀሙን የሚያውቁ ሰዎች ናቸው
אם הנפגע אינו מגיב ואינו נושם -	إذا لم يستجب ولم يتنفس المصاب	If the casualty does not respond and does not breath	Если пострадавший не реагирует и не дышит:	በሞት አደጋ ላይ ያለው ግለሰብ ምላሽ ካልሰጠ:
1. קרא לעזרה - חייג 101	1. أطلب مساعدة إتصل 101	1. Dial 101 for assistance	1. Позвоните в службу скорой помощи по номеру 101	እገዛ ለማግኘት ወደ 101 ይደውሉ::
2. דאג להבאת מכשיר החייאה (דפיברילטור)	2. عليك الاهتمام بإحضار جهاز الإنعاش (دفيبريلطور)	2. Make sure to bring in the defibrillator.	2. Организуйте доставку аппарата для реанимации ((дефибриллятора к месту нахождения пострадавшего.	ዲፍብሪላተሩን ይዘው መምጣት ያለውን እርግጠኛ ይሁኑ::

תקנות הצבת מכשירי החיאה במקומות ציבוריים, תשע"ד-2014

נוסח מלא ומעודכן

<p>ዲፍብሪላተሩ አስከፊ መሣሪያ ደረጃትን መጫን፣ በደረጃ መሃል ላይ በፍጥነት እና በሃይል መጥፋት ይጀምሩ።</p>	<p>3. До прибытия аппарата дефибриллятора начните массаж сердца путем быстрых и глубоких нажатий на центр грудной клетки пострадавшего.</p>	<p>3. Until the defibrillator arrives start chest compressions, rapid and deep pressure to the centre of the chest</p>	<p>3. حتى إحصار مכשיר החיאה, החל בביצוע עיסויי חזה, לחץ מהר ועמוק במרכז בית החזה</p>
<p>ዲፍብሪላተሩ ሲመጣ ያስጀምሩት እና በመሳሪያው የአጠቃቀም መመሪያ መሰረት ይፈጽሙ።</p>	<p>4. Подключите аппарат к пострадавшему и действуйте в соответствии с инструкциями озвучиваемыми аппаратом.</p>	<p>4. On arrival of the defibrillator activate and act according to the equipment guidelines</p>	<p>4. עם הגעת מכשיר החיאה, הפעל אותו ופעל בהתאם להנחיות המכשיר</p>

תוספת רביעית

(תקנה 9)

לכבוד משרד הכלכלה

תצהיר

אני הח"מ מס' ת"ז , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי מכשיר החיאה שברשותי הוא ציוד רפואי רשום בהתאם לחוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012 / רשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות (כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לא נכנס לתוקפו) וכי הוא הותקן על פי דרישות כל דין, ונבדק מדי שבוע בשנה האחרונה על ידי אחראי שמינתי בהתאם לתקנות הצבת מכשירי החיאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014. כמו כן, אני מצהיר כי המכשיר נבדק בתאריך _____ בהתאם לתנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות, כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לא נכנס לתוקפו, או בהתאם לתעודת הרישום עם כניסתו של חוק ציוד רפואי לתוקף. בדיקת המכשיר נעשתה על ידי ספק המכשיר / יצרן המכשיר / יבואן המכשיר / גורם אחר: _____, בהתאם לתנאי הרישום הללו. מצ"ב אישור הגורם שבדק את תקינות המכשיר על ביצוע הבדיקה. כמו כן אני מצהיר בזה כי המכשיר תקין כעת וכל ליקוי אשר התגלה בו כתוצאה מבדיקות תקינות אלה במהלך השנה האחרונה תוקן בהתאם לתעודת הרישום.

להלן פרטי המכשיר:

סוג המכשיר _____

כתובת המקום הציבורי שבו הוא מותקן _____

שם האחראי שמונה על ידי _____

תאריך _____ חתימה _____ חותמת _____

אני הח"מ, עורך דין, מאשר בזה כי ביום _____ הופיע לפני שזיהיתי אותו על ידי תעודת זהות מס' _____ ולאחר שהוזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם עליה בפני.

תאריך _____ חתימה _____ חותמת _____

נפתלי בנט
שר הכלכלה

כ"ז בסיוון התשע"ד (25 ביוני 2014)

[הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן](#)